OLIMED QUALIDADE EM SAÚDE	**Ficha Técnica** **Scalp Descartável com Sistema de Segurança - GLOMED**	**REG. Nº.: 222** **RESPONSÁVEL TÉCNICA:** **SIMARA COLOMBI BUSCH** **COREN/SC 273.138**

NOME TÉCNICO: SCALPES

NOME COMERCIAL: SCALP DESCARTÁVEL COM SISTEMA DE SEGURANÇA - GLOMED

REGISTRO ANVISA: 80273450025

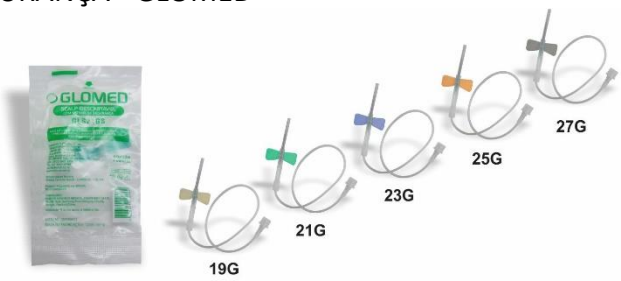

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.
CNPJ: 03.033.589/0001-12
Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central
Blumenau – SC – Brasil
CEP 89069-101
SAC 0800-645-2480

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE:
JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.,
No.78, North Suzhong Road,Baoying County, Jiangsu Province,China.

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

O Scalp descartável com sistema de segurança – GLOMED é composto por uma agulha siliconizada em aço inoxidável com diâmetro e comprimento variado, bisel curto e trifacetado, a agulha é revestida por uma capa protetora em polietileno, possui asas em PVC as quais são flexíveis e coloridas de acordo com a Norma 9753. Esta asa, após a utilização, desliza sobre a agulha, travando automaticamente e recobrindo a agulha. O dispositivo também apresenta tubo de PVC transparente medindo 30cm, o qual faz a ligação da agulha ao conector luer lock.

MODELOS DISPONÍVEIS:

MODELO	TAM	COMP. AGULHA	CALIBRE AGULHA	COLORAÇÃO DA ASA	EMBALAGEM PRIMARIA UNIDADES	EMBALAGEM COMERCIAL UNIDADES	CAIXA DE EMBARQUE UNIDADES
GLS27G-S	27Gx19	¾" (19mm)	27G (0,40 mm)	CINZA	01	X	2.000
GLS26G-S	26Gx19	¾" (19mm)	26G (0,45 mm)	MARROM	X	X	X
GLS25G-S	25Gx19	¾" (19mm)	25G (0,50 mm)	LARANJA	01	X	2.000
GLS24G-S	24Gx19	¾" (19mm)	24G (0,55 mm)	ROXO	X	X	X
GLS23G-S	23Gx19	¾" (19mm)	23G (0,60 mm)	AZUL	01	X	2.000
GLS22G-S	22Gx19	¾" (19mm)	22G (0,70 mm)	PRETO	X	X	X
GLS21G-S	21Gx19	¾" (19mm)	21G (0,80 mm)	VERDE	01	X	2.000
GLS20G-S	20Gx19	¾" (19mm)	20G (0,90 mm)	AMARELO	X	X	X
GLS19G-S	19Gx19	¾" (19mm)	19G (1,10 mm)	CREME	01	X	2.000
GLS18G-S	18GX19	¾" (19mm)	18G (1,20 mm)	ROSA	X	X	X

OLIMED QUALIDADE EM SAÚDE	**Ficha Técnica** **Scalp Descartável com Sistema de Segurança - GLOMED**	**REG. Nº.: 222** **RESPONSÁVEL TÉCNICA:** **SIMARA COLOMBI BUSCH** **COREN/SC 273.138**

DIMENSÕES DAS CAIXAS:

PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	COD. DE BARRAS UNITÁRIO	COD. DE BARRAS COMERCIAL	COD. DE BARRAS EMBARQUE
27G	10,00	0,50	0,29	0,62	0602883910903	0602883920897	0602883920880
26G	X	X	X	X	X	X	X
25G	10,00	0,50	0,29	0,62	0606529140786	0606529140755	0606529140816
24G	X	X	X	X	X	X	X
23G	10,00	0,50	0,29	0,62	0606529140779	0606529140748	0606529140809
22G	X	X	X	X	X	X	X
21G	10,00	0,50	0,29	0,62	0606529140762	0606529140731	0606529140793
20G	X	X	X	X	X	X	X
19G	10,00	0,50	0,29	0,62	0602883920873	0602883920866	0602883920859
18G	X	X	X	X	X	X	X

IMAGEM GRÁFICA:

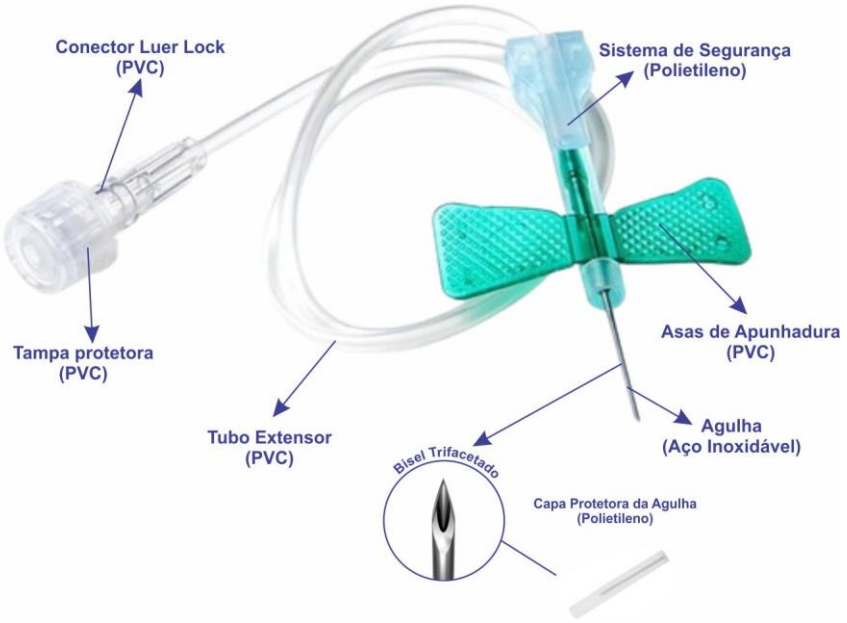

INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Indicado para introduzir soluções parenterais, de curta duração, com permanência de até 24 horas na veia, é utilizado também para procedimentos de coleta de sangue, seu mecanismo de segurança garante a proteção total da agulha atendendo a NR32.

EMBALAGEM/ESTERELIZAÇÃO:

Embalado individualmente em filme plástico transparente, abertura asséptica, rotulagem conforme RDC 751/2022; Caixa comercial com 100 unidades; Caixa de transporte 2.000unidades.

Rua Ricardo Georg nº 1.115 - Itoupava Central - 89.069-101 - Blumenau - SC
Fone/Fax: (47) 3144-9700 - Celular: (47) 99967-2318 - olimed@olimed.com.br - www.olimed.com.br
CNPJ: 03.033.589/0001-12 I.E: 253.869.366

OLIMED QUALIDADE EM SAÚDE	**Ficha Técnica** **Scalp Descartável com Sistema de Segurança - GLOMED**	**REG. Nº.: 222** **RESPONSÁVEL TÉCNICA:** **SIMARA COLOMBI BUSCH** **COREN/SC 273.138**

ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Verifique a integridade e validade do produto;
- Selecione o calibre apropriado de acordo com as necessidades clinicas do paciente;
- Garroteie o local a ser puncionado, aproximadamente de 5 a 10 cm do local da punção venosa, a fim de propiciar a dilatação da veia;
- Realize a assepsia do local escolhido, usando PVPI alcoólico ou álcool a 70%, partindo da porção distal do braço ou de baixo para cima, sempre no mesmo sentido;
- Com o bisel voltado para cima introduza o scalp na pele, quando observado a presença de retorno venoso, desgarrotear o braço do paciente;
- Retire a tampa de trava rosqueada, ligue a conexão ao equipo imediatamente após a retirada da proteção. Caso o procedimento seja para coleta de sangue, conectar a seringa e aspirar o sangue;
- Fixar o scalp na pele do paciente, deixando livre o local de conexão;
- Descarte o produto após sua utilização.

Nota: A tampa protetora do orifício de injeção deve permanecer fechada quando não estiver sendo utilizada.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilize nem reutilize, destrua após o uso;
- Armazenar em local seco, limpo em temperatura ambiente.

CONTRAINDICAÇÕES:

Scalp descartáveis com sistema de segurança são contraindicados em pacientes que não necessitam de punções frequentes e para indivíduos alérgicos aos materiais do scalp. Também não são apropriados em situações que demandem a visibilidade constante da agulha e em procedimentos que exijam agulhas específicas. Escolher dispositivos adequados à tarefa é fundamental para garantir a segurança e eficácia nos procedimentos de punção.

OLIMED QUALIDADE EM SAÚDE	**Ficha Técnica** **Scalp Descartável com Sistema de Segurança - GLOMED**	**REG. Nº.: 222** **RESPONSÁVEL TÉCNICA:** **SIMARA COLOMBI BUSCH** **COREN/SC 273.138**

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.
O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

_____

SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138

Rua Ricardo Georg nº 1.115 - Itoupava Central - 89.069-101 - Blumenau - SC
Fone/Fax: (47) 3144-9700 - Celular: (47) 99967-2318 - olimed@olimed.com.br - www.olimed.com.br
CNPJ: 03.033.589/0001-12 I.E: 253.869.366